



Informe de calibracion de Instrumentos

| Instrumento calibrado | |
|-----------------------|--------------------|
| Tipo: | Termometro Alcohol |
| Tag: | VNT-TA-25 |
| Marca: | - |
| Modelo: | - |
| S/N: | S/D |
| Rango: | -40 a 60 °C |


| Información de calibración | |
|----------------------------|-----------|
| N° de Acta | 30400000 |
| Procedimiento: | Contraste |
| Fecha: | 28/9/2021 |
| Fluido de prueba | N/A |

Patrones utilizados

| Tag | Marca | Modelo | N°Serie | Calibracion |
|-----|-------|--------------|---------|-------------|
| | Druck | DPI620-IS CE | 3505766 | 15/12/2020 |
| | | | | |
| | | | | |

Variable: °C

| | | | |
|---------|---------|--------|--------|
| Inicial | -20,000 | 18,000 | 49,000 |
| Final | -20,000 | 18,000 | 49,000 |
| Patron | -21,000 | 18,500 | 48,000 |
| Error % | 4,762 | 0,500 | -2,083 |

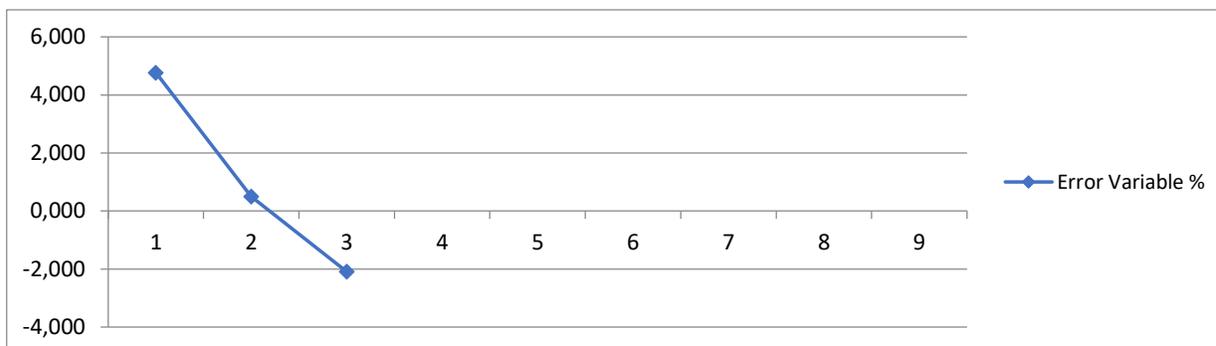

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %