



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Transmisor de presion
Tag:	PT-VT
Marca:	SIEMENS
Modelo:	SITRANS P
S/N:	N1-ED11-900067
Rango:	0 a 16 Bar

Información de calibración	
N° de Acta	30700070
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	5/3/2022
Fluido de prueba	Aire
Cliente	BUNGE PSM

Patrones utilizados


Tag	Marca	Modelo	NºSerie	Calibracion
	Druck	DPI620-IS CE	3505766	14/12/2020

UNIDAD: Bar

Inicial	0,000	3,990	7,990	11,980	15,980	11,980	7,990	3,990	0,000
Final	0,000	3,990	7,990	11,980	15,980	11,980	7,990	3,990	0,000
Patrón	0,000	4,000	8,000	12,000	16,000	12,000	8,000	4,000	0,000
Error P1 %	0,000	0,250	0,125	0,167	0,125	0,167	0,125	0,250	0,000

UNIDAD: mA

Inicial	4,000	7,990	11,990	15,980	19,980	15,980	11,990	7,990	4,000
Final	4,000	7,990	11,990	15,980	19,980	15,980	11,990	7,990	4,000
Patrón	4,000	7,990	11,990	15,980	19,980	15,980	11,990	7,990	4,000
Error mA %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

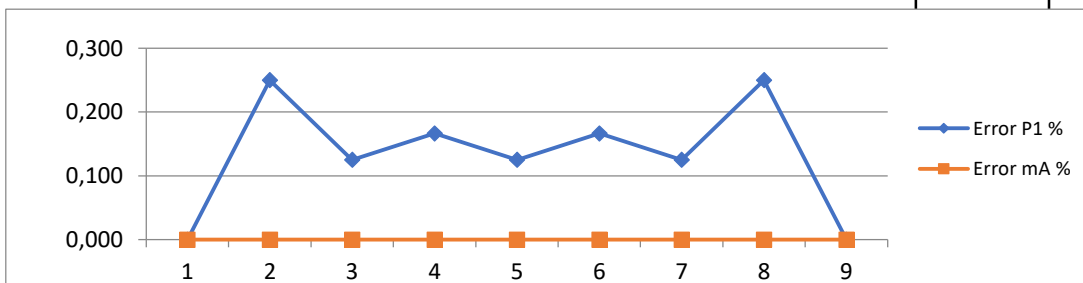

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: incertidumbre 0,4 El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico RODRIGO MAGALLANES

Revisado L. GUEMBERENA