



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Sensor de mezcla explosiva
Tag:	SME 120
Marca:	Honeywell
Modelo:	Optima Plus
S/N:	Z0176519320314
Rango:	0 - 100 %LEL


Información de calibración	
N° de Acta	03-0005-11783
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	13/3/2021
Fluido de prueba	Metano en N2 a 50% LEL
Ciente	LDC Timbues

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Fecha calibración
FLIX-UI-01	Fluke	709H	4547497	18/3/2020

UNIDAD: %LEL

SME mA	3,960	11,950
SME %	0,000	51,500
Patron	0,000	50,000
Error %	0,000	-3,000

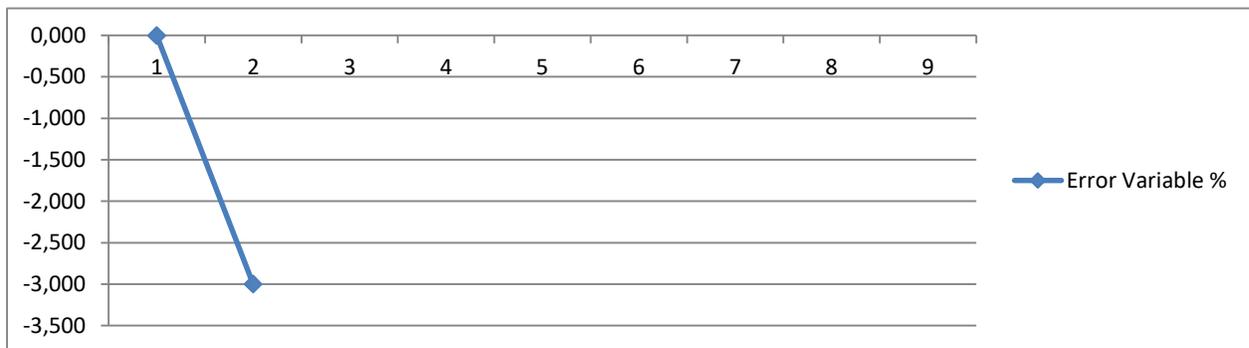

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: