

Flix Instrumentacion
Guido Spano 24, Fray Luis Beltran
Tel: 0341-152107596



Informe de calibracion de Instrumentos

| Instrumento calibrado | |
|-----------------------|-------------|
| Tipo: | Manometro |
| Tag: | PI 34721-02 |
| Marca: | NUOVA FIMA |
| Modelo: | |
| S/N: | |
| Rango: | 0 - 4 bar |


| Información de calibración | |
|----------------------------|-------------------------|
| N° de Acta | 3000100015 |
| Procedimiento: | Contraste y Calibracion |
| Fecha: | 22/3/2021 |
| Fluido de prueba | AIRE |
| Cliente: | EVONIK |

Patrones utilizados

| Tag | Marca | Modelo | NºSerie | Calibrado |
|-----|-------|--------------|---------|------------|
| | DRUCK | DPI620-IS CE | 3505766 | 14/12/2021 |
| | | | | |
| | | | | |

Variable: bar

| | | | | | | | | | |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Inicial | 0,000 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | 0,000 |
| Final | 0,000 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | 0,000 |
| Patron | 0,000 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | 0,000 |
| Error % | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

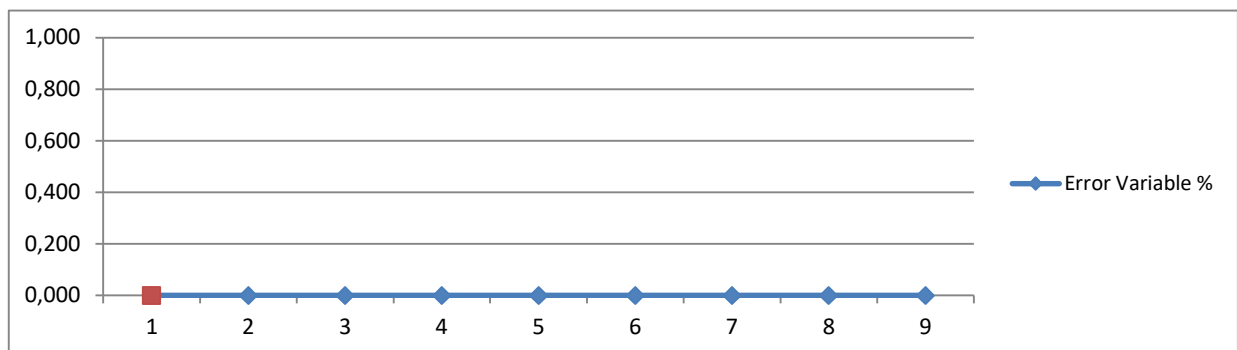

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones:

Técnico LUCAS VILLAFANE

Revisado L. GUEMBERENA