

Flix Instrumentacion
Guido Spano 24, Fray Luis Beltran
Tel: 0341-152107596



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Manometro
Tag:	MAN-030/1
Marca:	CENI
Modelo:	
S/N:	
Rango:	0 a 30 BAR


Información de calibración	
N° de Acta	50800084
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	21/2/2025
Fluido de prueba	AGUA
Cliente:	SUPPO

Patrones utilizados

Certificado	Marca	Modelo	N°Serie	Calibrado
23661	WIKA	CPG-1500	1A0130B4THO	22/3/2024

Variable: Bar

Inicial	0.000	5.000	10.000	20.000	30.000	20.000	10.000	5.000	0.000
Final	0.000	5.000	10.000	20.000	30.000	20.000	10.000	5.000	0.000
Patron	0.000	5.015	10.012	20.030	30.018	20.030	10.012	5.015	0.000
Error %	0.000	0.299	0.120	0.150	0.060	0.150	0.120	0.299	0.000

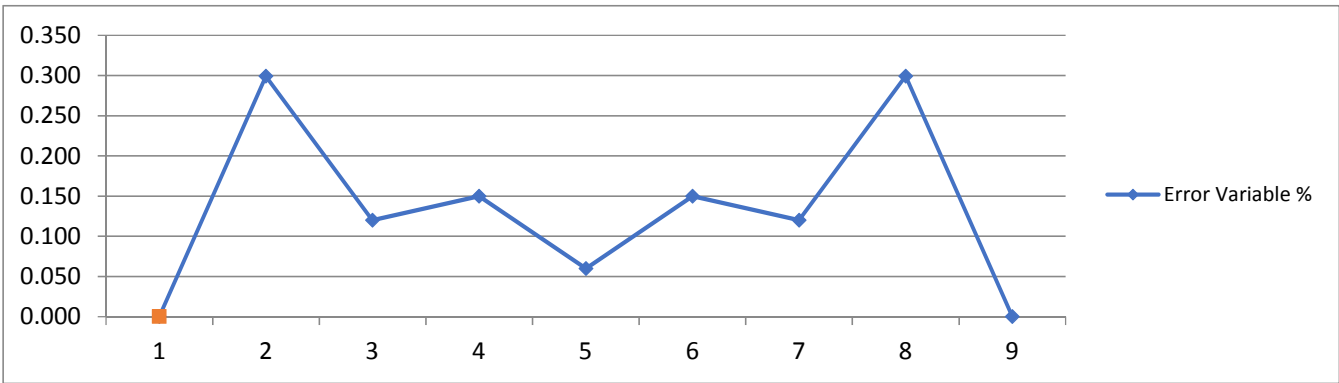

Resultado: ☒ Apto ☐ No Apto

Observaciones:

Técnico PABLO RODRIGUEZ Revisado L. GUEMBERENA