

Flix Instrumentacion  
Guido Spano 24, Fray Luis Beltran  
Tel: 0341-152107596



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Manometro
Tag:	MAN-020/5
Marca:	CENI
Modelo:	
S/N:	
Rango:	0 a 20 BAR


Información de calibración	
N° de Acta	50800088
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	24/2/2025
Fluido de prueba	AGUA
Cliente:	SUPPO

Patrones utilizados

Certificado	Marca	Modelo	N°Serie	Calibrado
23661	WIKA	CPG-1500	1A0130B4THO	22/3/2024

Variable: Bar

Inicial	0.000	5.000	10.000	15.000	20.000	15.000	10.000	5.000	0.000
Final	0.000	5.000	10.000	15.000	20.000	15.000	10.000	5.000	0.000
Patron	0.000	5.025	10.024	15.028	20.025	15.028	10.024	5.025	0.000
Error %	0.000	0.498	0.239	0.186	0.125	0.186	0.239	0.498	0.000

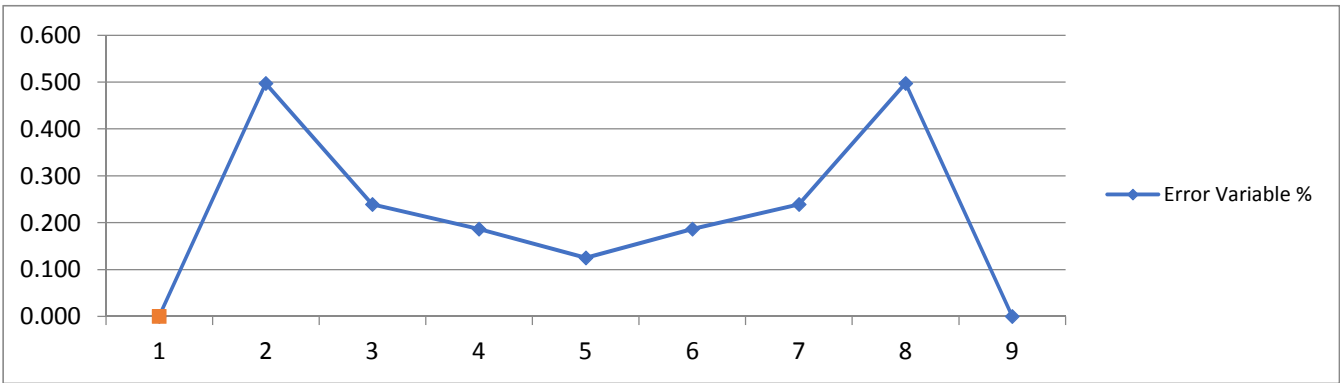

Resultado: ☒ Apto ☐ No Apto

Observaciones:

Técnico PABLO RODRIGUEZ Revisado L. GUEMBERENA